オールインワン シャワーキャリー(HT6731)
取扱説明書

1. 安全上の注意

1) ご使用前に、必ず六角ビスのゆるみやガタつきがないかご確認ください。
ゆるみやガタつきがある場合は、増し締めしてください。増し締め後もゆるみやガタつきがある場合は使用しないでください。
2) シャワーキャリー・簡易便器としての目的以外に使用しないでください。
3) 本品を改造しないでください。
4) パイプに水が入ってしまうため、お湯をはった浴槽内では使用しないでください。
5) 本品の各部に破損又は変形・変質などの異変がみられたときは使用しないでください。
6) 転倒するおそれがありますので､フットレストに足をかけて立ったり座ったりしないでください。
7) 転倒するおそれがありますので、背もたれ・肘掛けに体重をかけすぎないようにしてください。

2. 製品概要

1) 材質
本体：アルミニウム
座面/背もたれ/肘掛け：発泡ポリウレタン
2) サイズ
車体サイズ：幅 650×奥行 760×高さ 920㎜
座面サイズ：幅 400×奥行 400㎜
背もたれ高：350㎜（座面高：565㎜時）
380㎜（座面高：535㎜時）
肘掛け高：265㎜又は 295㎜（座面高：535㎜時）
235㎜又は 265㎜（座面高：565㎜時）
3) 重量：12.6kg
4) 耐荷重：150kg
5) 付属品：固定ベルト

バケツ（別売）を取り付けることで、簡易便器としても使用できます。

注文コード	品番	商品名
502-022-46	HT6731	ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ ｼｬﾜｰｷｬﾘｰ
502-022-13	HT0020	ﾊﾞｹﾂ,ｸﾞﾚｰ,蓋付,簡易便器用(502-022-10/40/42/46 用),取付ﾌﾚｰﾑ無し

3. 組立方法

＜構成品＞

メインフレーム

ホイール：2輪

フレーム付シート

フットレスト

肘掛け：2個セット
（固定ネジ付）


固定ネジ：（ボルト/ナット）
4個セット
（シート固定用）

1) まず、左右のアームを開いた状態で、左右前輪のストッパーをかけて固定してください（ストッパーを斜めに押し下げることで固定ができ、もとに戻すと固定が解除されます)。

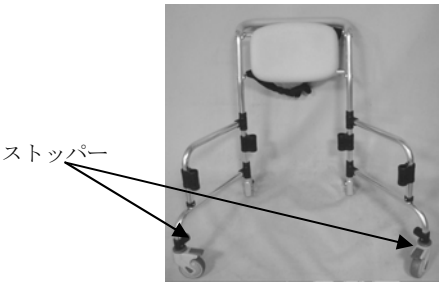

2) 左右後方の脚部にホイールを取り付ける際、PRESS と書かれたボタンを押しながら、ホイールシャフトを外側から奥まで入れてください。


PRESS 部の拡大

3) PRESS ボタンから手をはなし、ホイールシャフトが図のように出ていることを確認し、シャフト用固定ネジを締めこんでください。

4) 本体のブラケット4箇所にフレーム付シートのシャフトを差し込んでください。

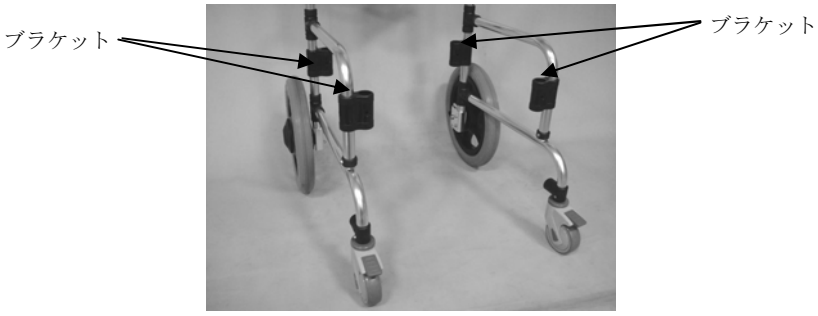

5) 本品を水平な床面に置き、高さを合わせてブラケットとフレーム付シートのシャフトを固定ネジでしっかり固定してください。
前方からボルトを差し込み、後方からナットで締め込みます。
※フレーム付シートは 2 段階の高さ調節が可能です。必ず前後左右の高さを合わせて固定してください。

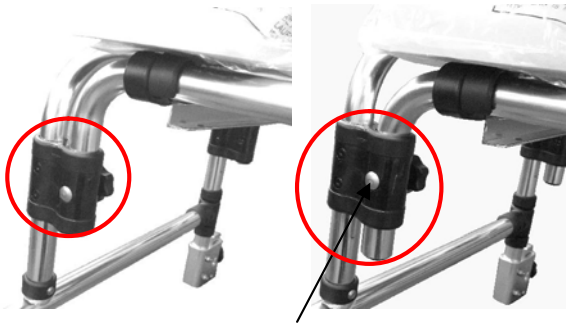

固定ネジ（ボルト/ナット）

6) フットレストを約 40° の角度で折り曲げ、プッシュボタンを押しながらブラケットに後方から差し込んでください。最後にフットレストを手前におろしてください。

フットレストの折り曲げ → ブラケットへの差し込み → 手前におろしてください

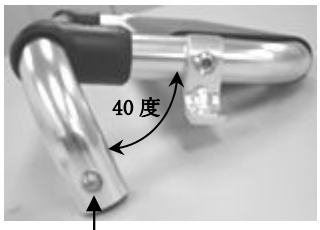

プッシュボタン

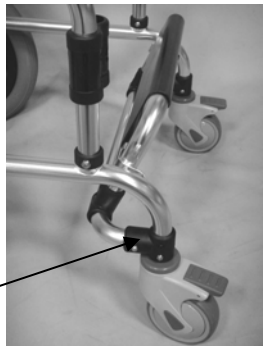

ブラケット

注意

フットレストのプッシュボタンは、深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったんフットレストを引き抜いてプッシュボタンを出してから、再度差し込んでください。
また、ボタンが確実に固定穴にはまっていることを確認してください。

プッシュボタンが出た状態を確認

7) 左右の高さの取付位置を合わせ、固定ネジでしっかり固定してください。シャワーキャリー本体の内側からボルトを差し込み、外側からナットで締め込みます。
※肘掛けは 2 段階の高さ調節が可能です。必ず左右の高さを合わせて固定してください。

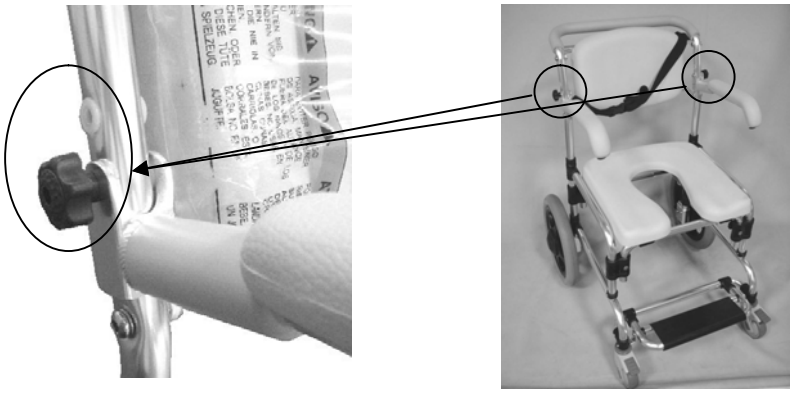

4. 使用方法

浴室や脱衣場など、屋内の平らな場所でご使用ください。

⚠ 注意

① 立ったり座ったりする際は必ず介助者が付き添って前輪のストッパーをロックし、介助者が本品を後ろから支える等、安全性に留意してください。
② 浴室などの床が濡れた場所での使用の際、踏み台のように本品の上に立ち上がるなどの行為は、大変危険ですので絶対に行わないでください。
③ シャワーチェアーとして使用する場合、必ず前輪のストッパーをロックしてください。
④ 簡易便器として使用する場合、バケツ（別売）が取り付けられているのをご確認ください。
⑤ 移動する際は、介助者が立ち止まって安全に止まることができる速度でご使用ください。
⑥ 必ず平らな面に設置してください。また、シートに浅く腰掛けると転倒するおそれがありますので、シートの中央に正しく腰掛けてください。
⑦ 勢いよく座ると破損や転倒のおそれがありますので、ゆっくり腰掛けてください。

5. お手入れと保管方法

1） お手入れ

① 腐食等の原因になりますので、ご使用後は水を切ってじゅうぶん乾燥させてください。
② 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤又は消毒用アルコール液を含ませた柔らかい布で清拭してください。

2） 点検

① 各部に傷、亀裂、ゆがみ、ガタつき、変形がないことをご確認ください。
② フットレスト、肘掛けがスムーズに動くか、ネジのゆるみがないかご確認ください。
③ 前輪・後輪がスムーズに動くかご確認ください。
④ 前輪のストッパーで確実にロックできるかご確認ください。

※異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

3） 保管方法

前輪のストッパーをロックし、湿気の少ない場所で保管してください。

6. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/